


ECMO OXIGENAÇÃO EXTRACORPÓREA

Equipamento 1 de oxigenação extracorpórea da marca BRAILE BP 18879 adquirido em 13/04/2021 no valor de R\$210.000,00 número de série 2010019. E equipamento 2 de oxigenação extracorpórea da marca BRAILE BP 19010 adquirido em 31/05/2021 no valor de R\$192.505,00 número de série 2010008. Considerando depreciação para 10 anos de uso de vida útil do equipamento pelo método linear conforme **NBR 14653 – 1**, conforme figura abaixo:

Avaliação Método Linear Equipamento 1 BP 18879

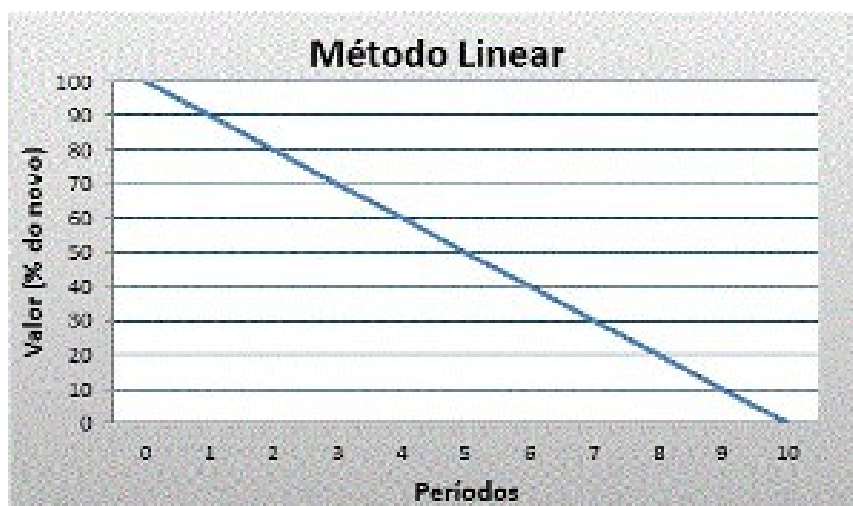


Equipamento:	ECMO BP 1879
Data da aquisição:	13/04/2021
Vida útil	10 anos
Depreciação anual:	R\$21.000,00
Tempo de uso:	3 anos
Valor atual depreciado em 3 anos de uso:	R\$147.000,00

ECMO OXIGENAÇÃO EXTRACORPÓREA

Equipamento 2 de oxigenação extracorpórea da marca BRAILE BP 19010 adquirido em 31/05/2021 no valor de R\$192.505,00 número de série 2010008. Considerando depreciação para 10 anos de uso de vida útil do equipamento pelo método linear conforme **NBR 14653 – 1**, conforme figura abaixo:

Avaliação Método Linear Equipamento 2 BP 19010

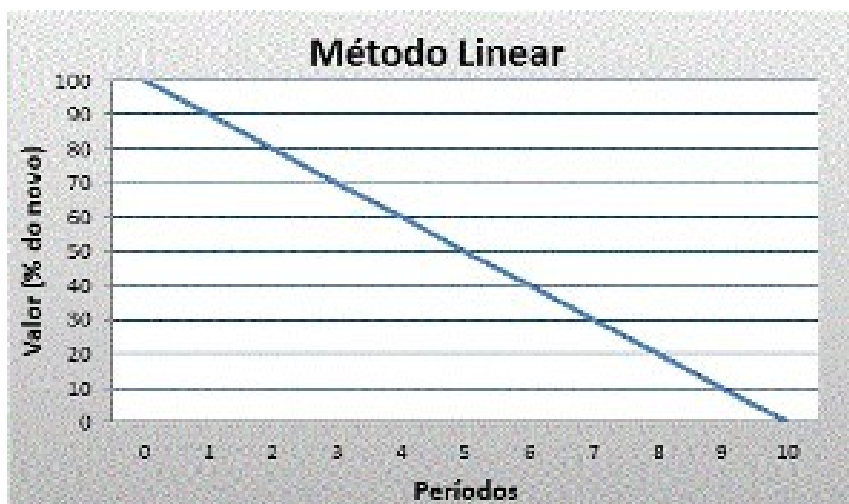

Equipamento:	ECMO BP 19010
Data da aquisição:	31/05/2021
Vida útil	10 anos
Depreciação anual:	R\$19.250,50
Tempo de uso:	3 anos
Valor atual depreciado em 3 anos de uso:	R\$134.753,50

Conclusão

Os equipamentos utilizados para terapia de pacientes com COVID 19 foram utilizados no máximo 15 pacientes e estão sem uso no momento atual. Os equipamentos contém: Carro de transporte, bomba manul, display, sistema de circulação e aquecimento, nobreak dedicado e suportes para demais usos. As fotos podem ser observadas no Anexo. Os equipamentos estão aptos ao uso e em plena condição de terapia.



Welisson Vogado Fernandes

CREA: PR-121999/D

Foz do Iguaçu 03 de Setembro de 2025

ECMO OXIGENAÇÃO EXTRACORPÓREA



ECMO OXIGENAÇÃO EXTRACORPÓREA

